エマージェンシータニケット　P-910A
取扱説明書

1. 安全上の警告・注意

1) ラテックスアレルギーの患者もしくはその疑いがある患者には使用しないでください。
2) 使用目的以外に使用しないでください。
3) 本品の二次的加工をしないでください。
4) 組織の壊死や麻痺を防ぐため、締め付けは 30 分を限度としてください。
   注）締め付けの限度時間は、患者の容体により異なります。締め付けが長時間に及ぶ場合は、30 分を限度にゆるめてください。

2. 製品概要

本品のみあるいはプレッシャーブリッジと組み合わせて使用します。

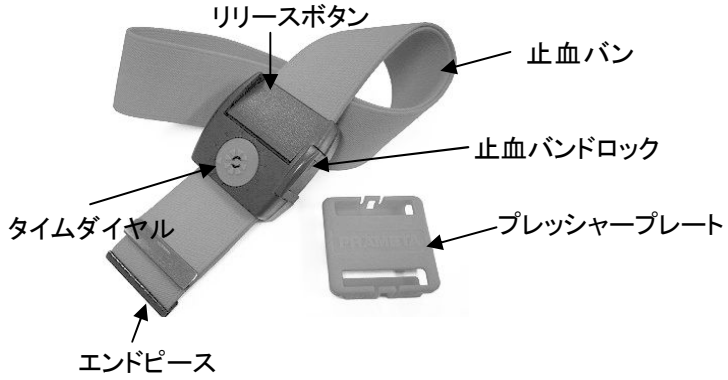

プレッシャーブリッジ（別売）
圧迫止血を行う際にご利用ください。

バンド材質：ラテックス・ポリアミド・木綿の混紡織物

注文コード	品番	商品名
362-002-01	P-910A	エマージェンシータニケット
362-002-70	P-910-10	止血バンド
362-002-71	P-910-20	プレッシャーブリッジ

3. 一般的な使用方法とその注意事項

1) タイムダイヤルを止血開始時刻に合わせます。

例:7時OO分止血開始

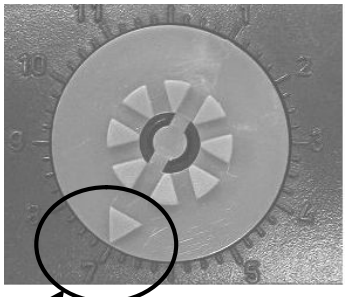

2）圧迫する位置にバンドを固定します。

※必要であれば止血バンドロックを開け、バンドを固定してください。

止血バンドロックを開けた状態

3）止血バンドロックを保持しながら両方のバンドを引っ張り締め付けます。

4）ゆるめる際にはリリースボタンを押します。

4. 清掃、消耗品の交換、保管方法に関する事項

1）洗浄・消毒・滅菌方法

① 止血バンドロック、プレッシャープレート、プレッシャーブリッジ
洗浄方法：石鹸水又は非侵襲性洗浄液で洗浄してください。煮沸可能です。
滅菌方法：高圧蒸気滅菌（135℃/30 分）が可能です。

② 止血バンド
洗浄方法：煮沸可能です。
消毒方法：アルコールを含んだ溶液に浸漬（約 45 分）するか、その溶液をスプレーしてください。その後、約 3～4 時間自然乾燥してください。
滅菌方法：高圧蒸気滅菌（135℃/30 分）が可能です。

2）止血バンドの交換方法
止血バンドロックを開けて使用済みのバンドを引き抜き、新しいバンドに交換してください。

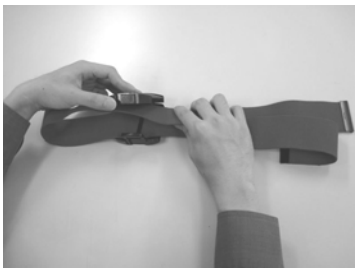

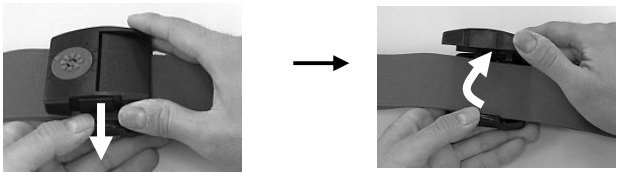
止血バンドロックをあけているところ

3）保管方法
清潔で良好な乾燥状態の保てる場所で保管してください。

5. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL　0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp